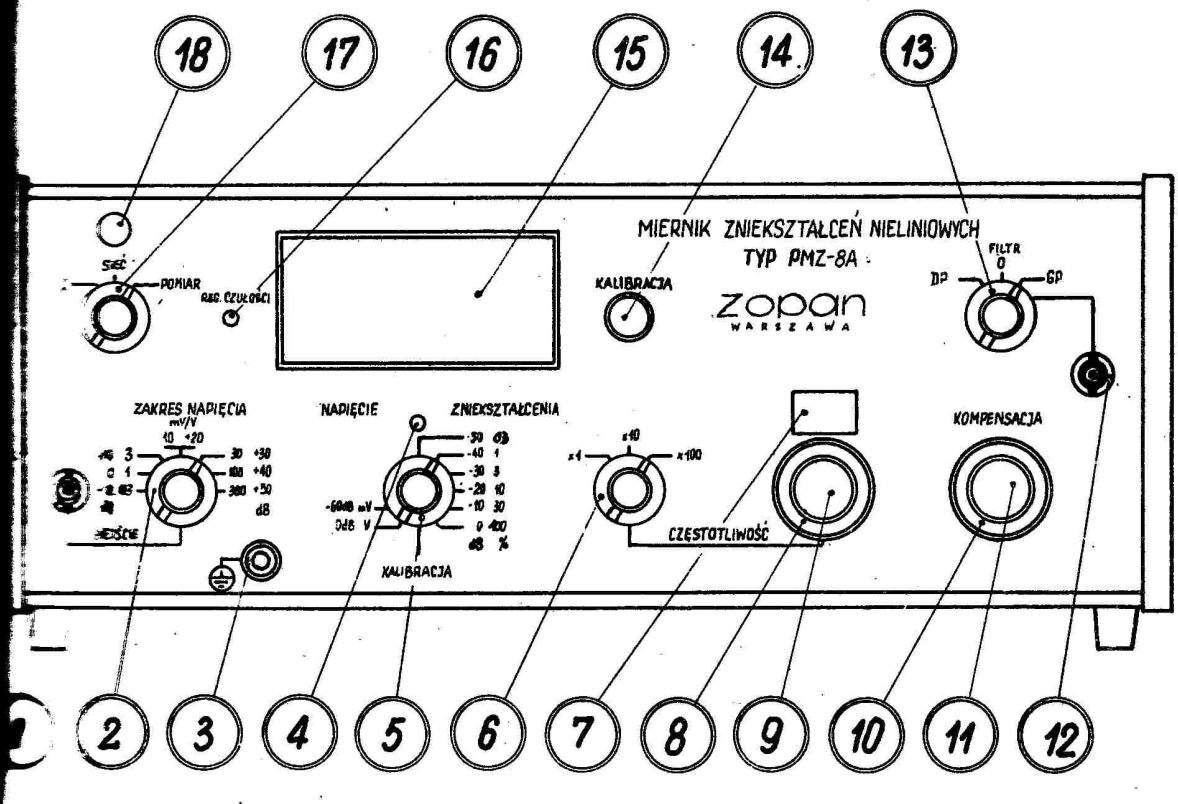
18
17
16
15
14
13
SIEĆ
POMIAR
REG. CZUŁOŚCI
MIERNIK ZNIEKSZTAŁCEŃ NIELINIOWYCH
TYP PMZ-8A
KALIBRACJA
zopan
WARSZAWA
FILTR
DP
GP
ZAKRES NAPIĘCIA
mV/V
WEJŚCIE
dB
NAPIĘCIE
ZNIEKSZTAŁCENIA
KALIBRACJA
x1
x10
x100
CZĘSTOTLIWOŚĆ
KOMPENSACJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

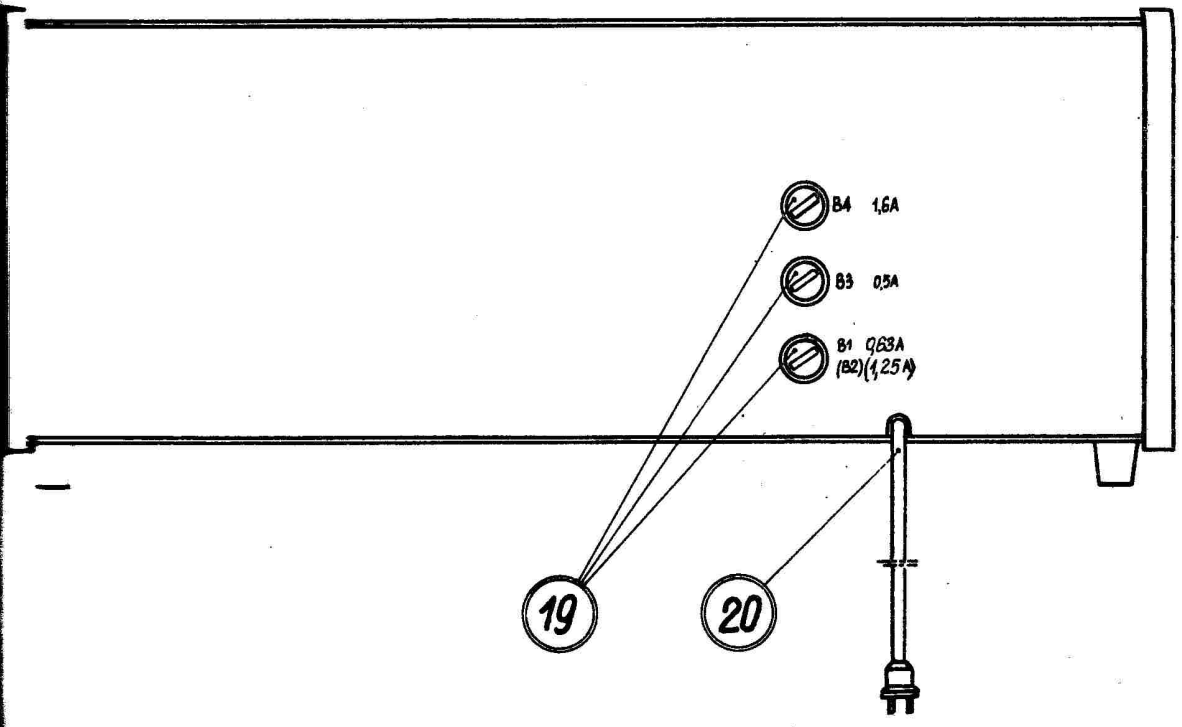
B4 1,6A
B3 0,5A
B1 0,63A
(B2)(1,25A)
19
20